

Haus Schaeben GmbH & Co. KG
Europaallee 42
50226 Frechen
DEUTSCHLAND

Münster, 25.02.2026

Zertifikat

über das kosmetische Produkt

Schaebens Ultra Hydro Icing Maske Cryo-Serum

**Klinische Anwendungsstudie unter dermatologischer Kontrolle
und Bestimmung der Hautfeuchtigkeit**
(Testzeitraum: Januar/Februar 2026)

Studiennummer ST-AT-2025-00295

Die Corneometriemessung des Präparates **Schaebens Ultra Hydro Icing Maske Cryo-Serum** zur Überprüfung der Wirkung auf die Hautfeuchtigkeit wurde mit der Corneometersonde CM® 825 (Firma Courage+Khazaka) an 20 weiblichen und männlichen Probanden durchgeführt. Die Veränderung der Hautfeuchtwerte wurde im behandelten und unbehandelten Testareal vor und nach 24 Stunden Anwendung des Präparates bestimmt. Es konnte eine Verbesserung der Hautfeuchtigkeit nach 24 Stunden von maximal 223,19% und von durchschnittlich 54,44 % im Testareal gezeigt werden. Zusammenfassend kann aus dermatologischer Sicht festgestellt werden, dass das Präparat


Schaebens Ultra Hydro Icing Maske Cryo-Serum

in der Anwendung nach klinisch-dermatologischen Kriterien sehr gut vertragen wurde und zu einer deutlichen Verbesserung der Hautfeuchtigkeit führte.

Aufgrund des gewählten Studiendesigns und der sehr guten Verträglichkeit kann für das o.g. Präparat die 5-Sterne-Garantie vergeben werden.



Dermatest® GmbH • dermatest.com
Nevinghoff 30 • 48147 Münster

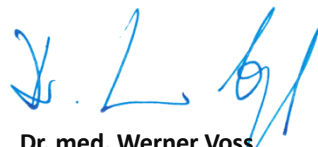

Dr. med. Werner Voss
Facharzt für Dermatologie,
Venerologie, Allergologie,
Phlebologie und Umweltmedizin

Haus Schaeben GmbH & Co. KG
Europaallee 42
50226 Frechen
DEUTSCHLAND

Münster, 25.02.2026

Zertifikat

über das kosmetische Produkt

Schaebens Ultra Hydro Icing Maske Cryo-Serum

Klinische Anwendungsstudie unter dermatologischer Kontrolle und Bestimmung der Hauttemperatur

(Testzeitraum: Januar/Februar 2026)

Studennummer ST-AT-2025-00295

Die Hauttemperaturmessung des Präparates **Schaebens Ultra Hydro Icing Maske Cryo-Serum** zur Überprüfung der Wirkung auf die Hauttemperatur wurde mit der MX6 PhotoTemp Infrared Thermometer (Fluke Process Instruments) an 20 weiblichen Probanden durchgeführt. Die Veränderung der Hauttemperatur wurde im behandelten Testareal vorher und 10 Minuten nach der ersten Anwendung des Präparates bestimmt. Es ergab sich eine Veränderung der Hauttemperatur von maximal $-7,87^{\circ}\text{C}$ und von durchschnittlich $-3,51^{\circ}\text{C}$ im Testareal. Zusammenfassend kann aus dermatologischer Sicht festgestellt werden, dass das Präparat

Schaebens Ultra Hydro Icing Maske Cryo-Serum

in der Anwendung nach klinisch-dermatologischen Kriterien sehr gut vertragen wurde und zu einer Veränderung der Hauttemperatur führte.

Aufgrund des gewählten Studiendesigns und der sehr guten Verträglichkeit kann für das o.g. Präparat die 5-Sterne-Garantie vergeben werden.



Dermatest® GmbH • dermatest.com
Nevinghoff 30 • 48147 Münster



Dr. med. Werner Voss
Facharzt für Dermatologie,
Venerologie, Allergologie,
Phlebologie und Umweltmedizin